


SFT-Ph-Meter

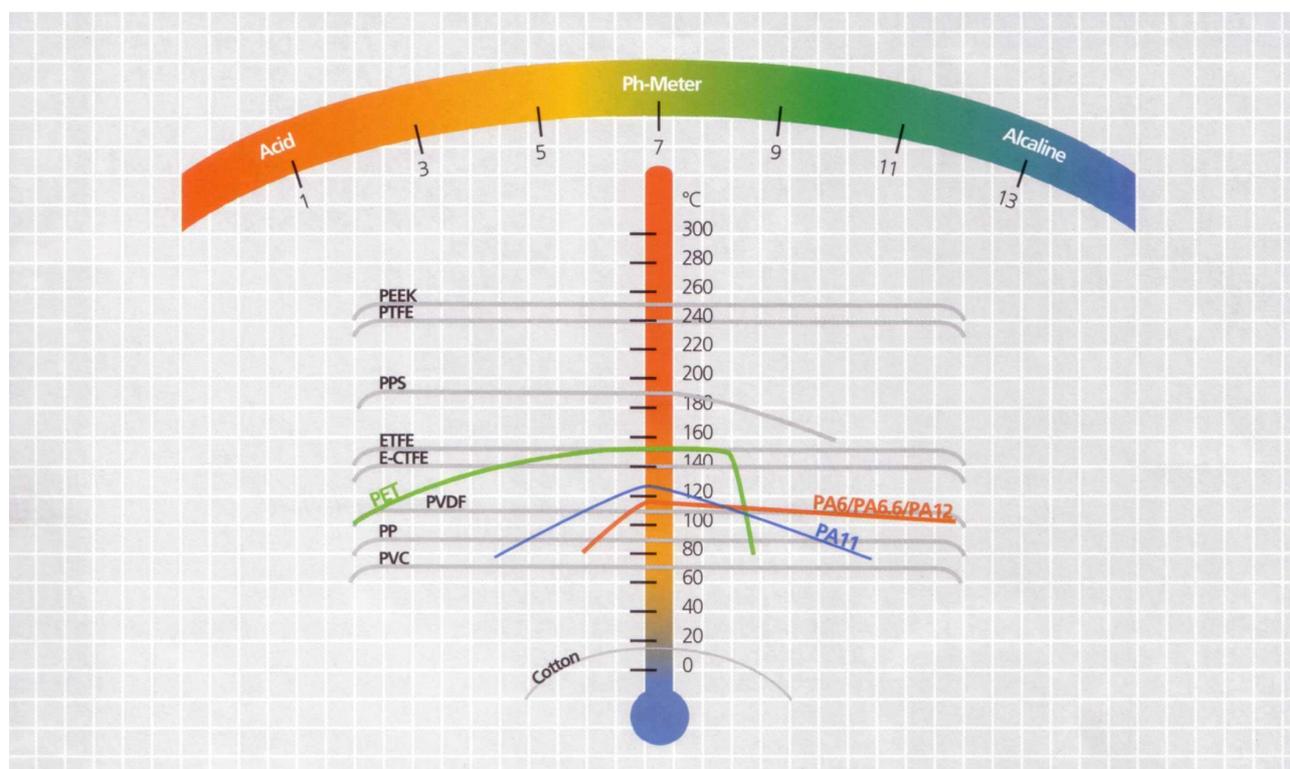

Bei den Angaben handelt es sich um ungefähre Werte, die von der Konzentration der Suspension und von der Dauer des Filtrvorgangs abhängig sind. Weitere Auskünfte zu einzelnen Chemikalien erteilen wir Ihnen gerne.